



Tests réalisés en 1990

## SOCIETE INTERNATIONALE DE RECHERCHE SUR L'ELETROSMOG (IGEF)

IGEF Certificats  
IGEF Laboratoire d'essai et d'épreuve  
**BREVES INFORMATIONS SUR L'ANALYSE**

**Relatives à l'évaluation des caractéristiques du « PxD Mobichip » de l'entreprise PxD Système, Macédoine en ce qui concerne l'action préventive contre la radiation électromagnétique lors de l'usage de téléphones portables.**

Le Laboratoire d'essai et d'épreuve IGEF a testé l'action préventive du « PxD Mobichip » de l'entreprise PxD Système, Macédoine contre la radiation électromagnétique lors de l'usage de téléphones portables. Les brèves informations présentent les résultats fondamentaux de cette recherche. L'analyse a confirmé le 02.06.2007 que

### « PxD Mobichip »



De l'entreprise PxD Système  
Leninova 79/1  
1000 Skopje  
Macédoine  
Tél. / Télécopie : ++389 2 3229 473  
Internet : <http://www.pxds.com>  
E-mail : [marketing@pxds.com](mailto:marketing@pxds.com)

est conforme à assurer une protection de l'organisme contre les radiations électromagnétiques nuisibles de l'électrosmog. Il est également conforme à un usage avec d'autres appareils (tels que les surveille-bébés, WLAN radio / réseau TV). Les exigences de la société internationale de recherche sur l'électrosmog IGEF permettant ainsi la délivrance de certificat autorisé et recommandé par l'IGF.




Les preuves de l'action préventive de « PxD Mobichip » sont obtenues par le processus de l'effet bio-réflexif. 13 personnes ont été testées. Outre la réduction du potentiel de stress, l'influence du « PxD Mobichip » sur le développement des processus rythmiques dans l'organisme a également été testée, comme l'adaptabilité du corps humain aux influences externes.


## Résultats fondamentaux de l'étude réalisées par la mise en œuvre du processus de l'effet bio-réflexif

### 1. Réduction du potentiel de stress


La valeur moyenne du potentiel de stress a été réduite de 13% chez toutes les personnes testées, alors que la réduction de la valeur du potentiel de stress chez les personnes testées individuellement a atteint 34%. La courbe relative à la conductibilité de la peau suite à l'utilisation du « PxD Mobichip » a été harmonisée de manière significative.

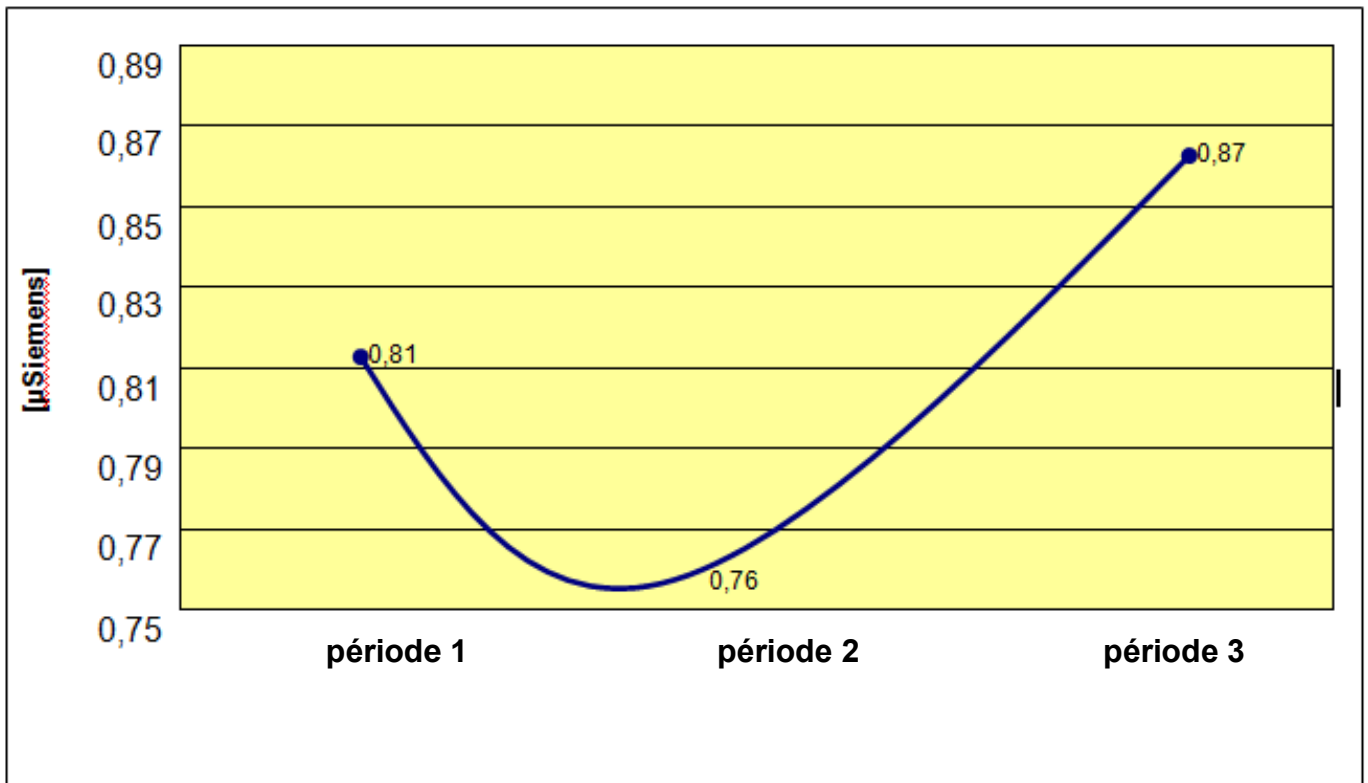

### 2. Amélioration de la variabilité des pulsations cardiaques

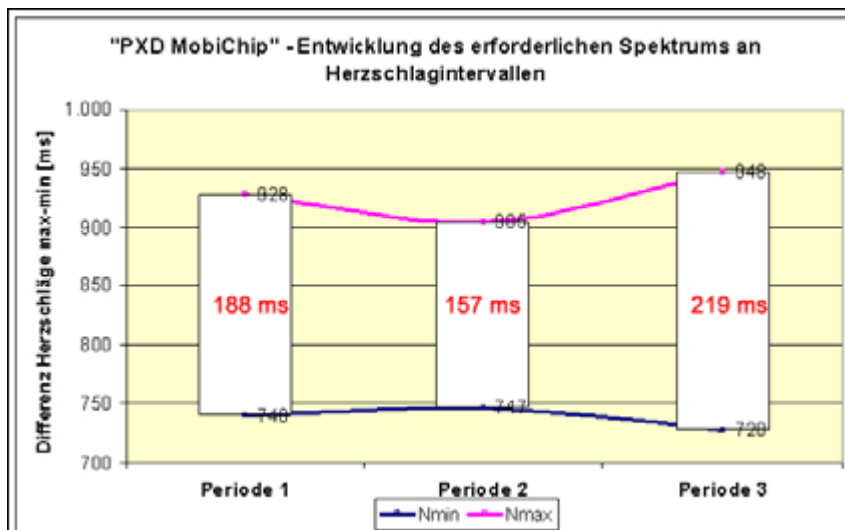

« PxD Mobichip » - Développement du pouvoir (Total Power) du système neurovégétatif

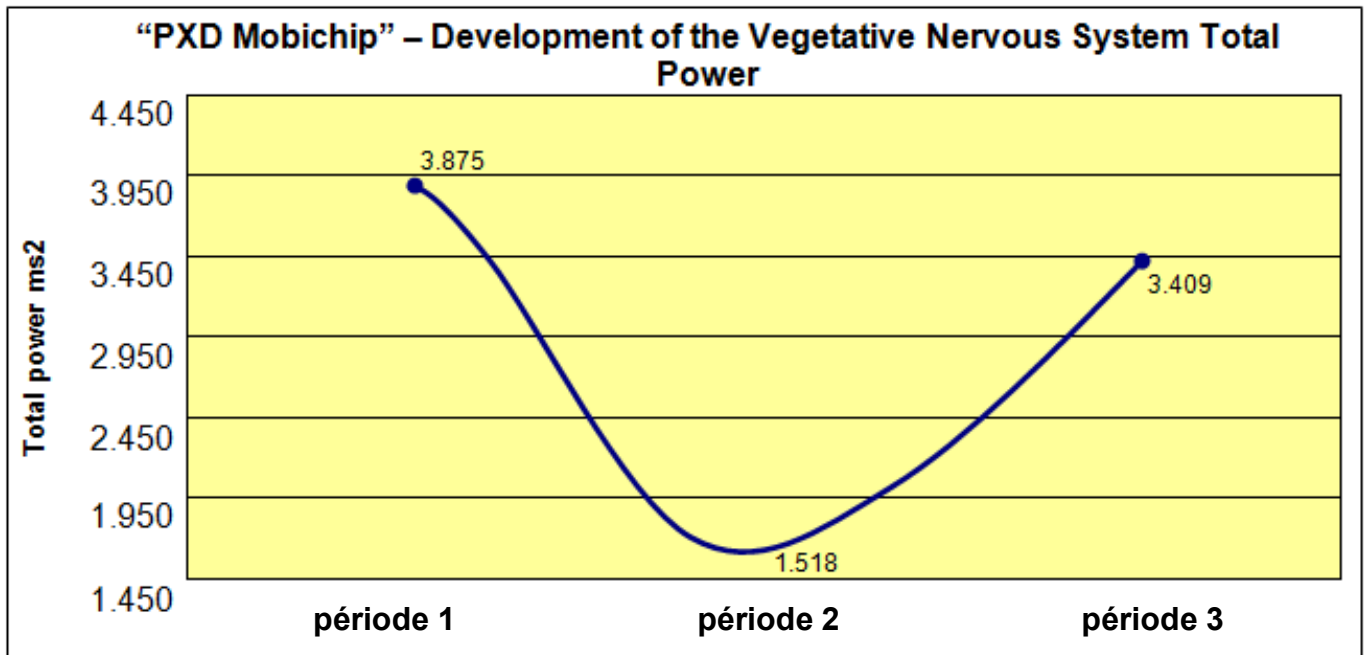

Les résultats des recherches ont indiqué que le champs d'information du « PxD Mobichip » harmonise les actions nuisibles des champs électromagnétiques lors de leur influence biologique sur l'organisme et contribue à maintenir l'équilibre interne de l'organisme de l'homme. Le pouvoir total du système neurovégétatif est réduit de plus de 50% lors de l'utilisation du « PxD Mobichip ». Nous constatons également une réduction du nombre des paires successives des intervalles des pulsations cardiaques avec une différence > 50 ms, grâce aux champs d'informations du « PxD Mobichip ».

Ingénieur Paul Somer  
Responsable du Laboratoire de recherche IGEF