



Исследования 1990 года

**МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОСМОГА  
IGEF СЕРТИФИКАТЫ  
IGEF исследовательская лаборатория**

**КОРОТКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ АНАЛИЗА**

**Оценки ПХД Мобичипа компании ПХД систем, Македония в отношении действия защиты против электромагнетного облучения ПХД Мобичипа при употреблении мобильного телефона**

В IGEF лаборатории исследования и доказательства испытано действие защиты ПХД Мобичипа компании ПХД систем, Македония против электромагнетного облучения при употреблении мобильного телефона. Эта короткая документация представляет существенные результаты испытания. Анализ подтвержден 02.06.2007 года.



**ПХД Мобичип**

Компании ПХД систем,  
Ленинова , 79/1  
1000 ,Скопье  
Македония  
Тел/факс: ++389 2 3229 473  
Интернет: <http://www.pxds.com>  
e-mail:marketing@pxds.com

Соответствует для защиты организма от негативного влияния электромагнетного облучения, а также подобен при употреблении других аппаратов как например: телефона для новорожденного, WLAN радио/тв сети. В соответствии с этим удовлетворенны требования Международного общества для исследования электросмога и получена печать о одобрении иа также рекомендуется IGEF –ом.




Доказательства о защитном действии ПХД Мобичипа получены через процесс биовозвратного эффекта. Тэст прошли 13 человек. Кроме уменьшения стрэсного потенциала было исследованно и влияние ПХД Мобичипа на развитие процесса в организме, а также приспособление тела к наружным влияниям.


## Существенные результаты при процессе биовозвратного эффекта.

### 1. Уменьшение стрессного потенциала


Средний показатель стрессного потенциала уменьшился на 13% у всех, у некоторых испытуемых средний показатель достиг и до 34%. Кривая линия проводимости кожи при употреблении ПХД Мобичипа значительно гармонизируется.

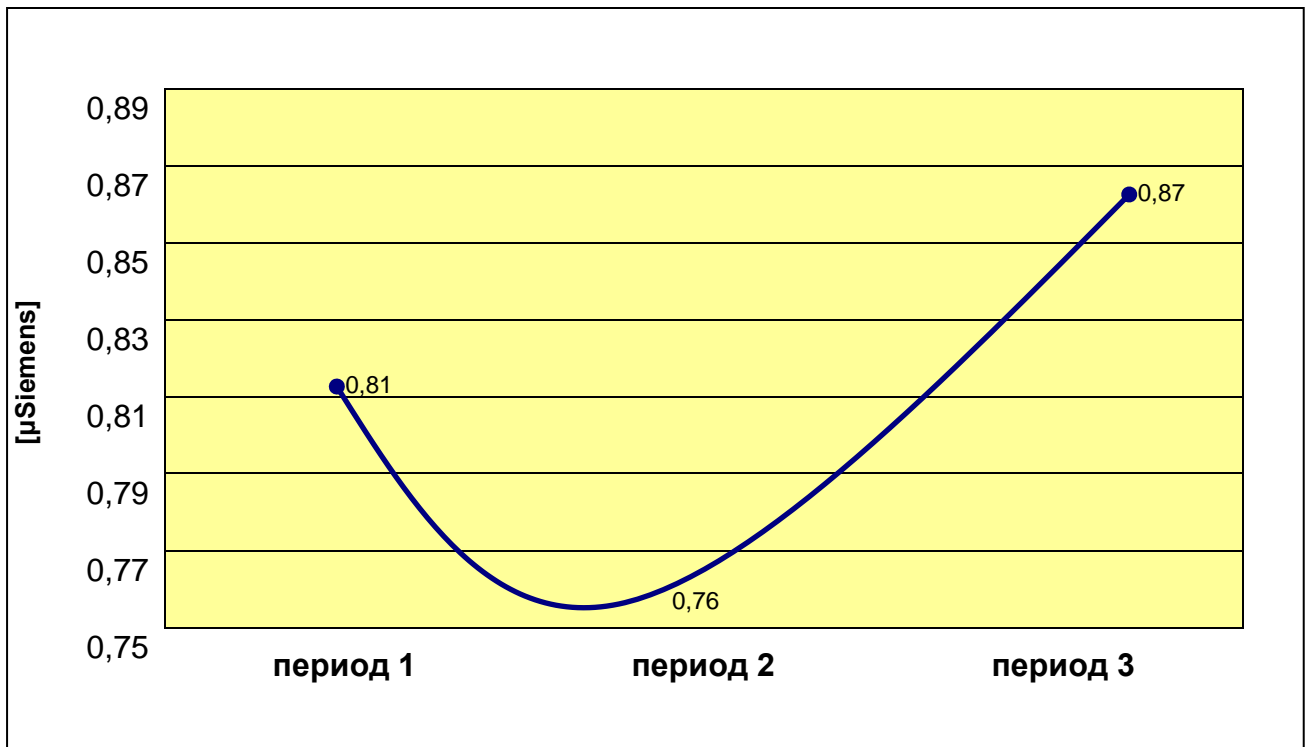

### 2. Улучшение вариабилитета пульсации сердца

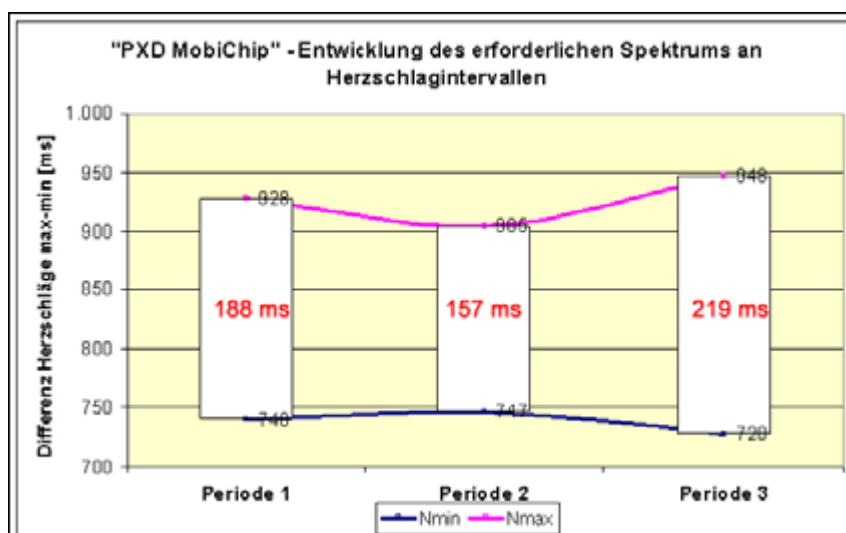

## ПХД Мобичип – Развитие целокупной мощности (Total Power) вегетативной нервной системы

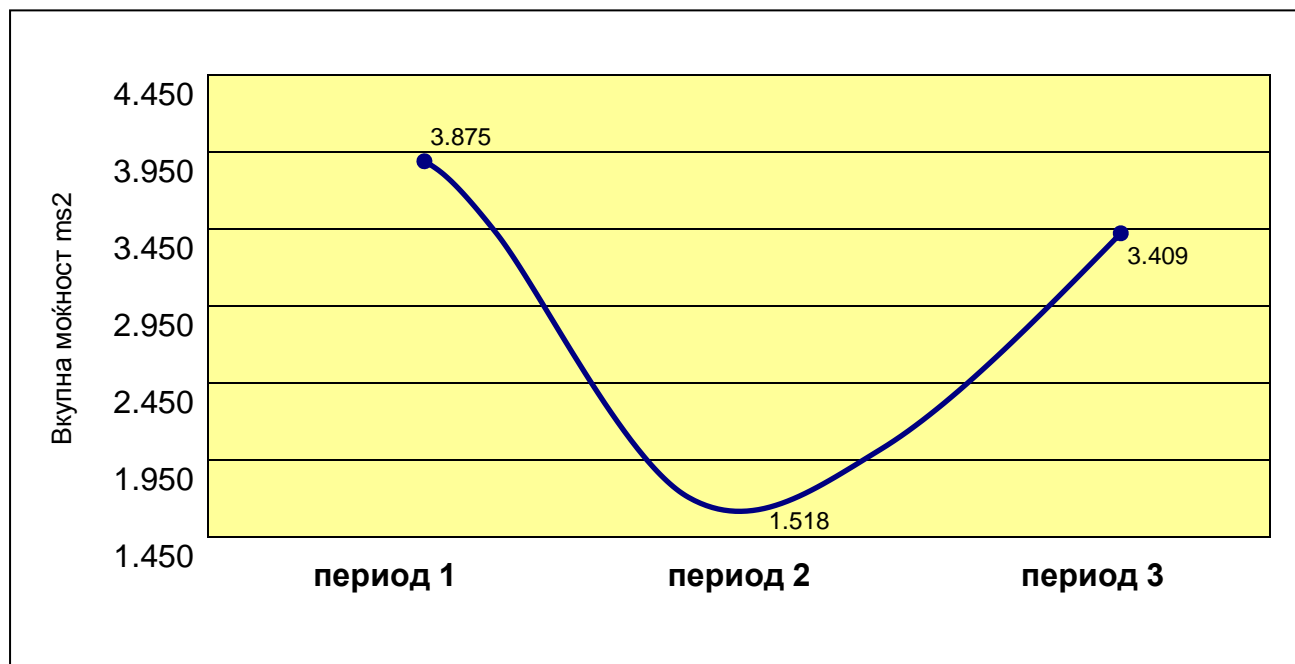

Результаты исследования показали што информационное поле ПХД Мобичипа гармонизирует негативное влияние электромагнитных полей при биологическом влиянии на организм и способствует сохранению внутреннего балланса в организме человека. Целокупная мощность вегетативной нервной системы уменьшается на более 50% при употреблении ПХД Мобичипа, а также уменьшается и число регистрированных последовательных четных интервалов пульсации сердца в разнице >50 ms, благодаря информационному полю ПХД Мобичипа.

Инженер: Пауль Сомер-  
руководитель  
IGEF лаборатории для исследования.

