



Investigaciones desde 1990

**ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ELECTROSMOG (IGEF)  
IGEF CERTIFICADOS  
IGEF laboratorio de investigación y comprobación**

**ABREVIADA DOCUMENTACIÓN DEL ANÁLISIS**

**para la valuación del “PXD Microchip” de la compañía PXD Sistema, Macedonia en cuanto al efecto protector con respecto a las radiaciones electromagnéticas durante el uso de los teléfonos celulares.**

El laboratorio de investigación y comprobación IGEF examinó la función protectora del “PXD Microchip” de la compañía PXD Sistemas, Macedonia en relación a su función protectora contra radiaciones electromagnéticas durante el uso de teléfonos celulares. Esta documentación abreviada proporciona una vista muy clara de los resultados de tales investigaciones. El análisis detallado de 22.06.2007 confirmó que:



**“PXD Microchip”**  
de la compañía PXD Sistema  
Leninova 79/1  
1000 Skopje  
Macedonia  
Tel./fax: ++389 2 3229 473  
internet: <http://www.pxds.com>  
E Mail: [marketing@pxds.com](mailto:marketing@pxds.com)

es apropiado para la protección del organismo contra las radiaciones electromagnéticas dañinas del electrosmog. Es también muy adecuado para el uso con otros aparatos como (bebé-teléfono, WLAN radop/TV redes). Con eso se cumplen los requisitos de la asociación internacional para la investigación del electrosmog IGEF y se ha obtenido el sello autorizado y recomendado por IGEF.




Las pruebas de la acción protectora del “PXD microchip” se han obtenido por medio del proceso de efecto biorecurrente. 13 personas han sido examinadas. Aparte de la reducción de la potencia del stress, los efectos del “PXD Microchip” sobre el desarrollo de los procesos rítmicos en el organismo y la adaptabilidad del cuerpo humano a las influencias exteriores también han sido examinadas.


Resultados importantes del estudio llevado a cabo por medio del proceso de efecto bio-recurrente.

### 1. Reducción del potencial del stress.


El valor promedio del potencial del stress ha sido reducido en todos los examinados por 13%, y entre los examinados individualmente el valor del potencial del stress ha alcanzado hasta 34%. La curva de la conductividad de la piel durante el uso del "PXD Microchip" se hamoniza de una manera significativa.

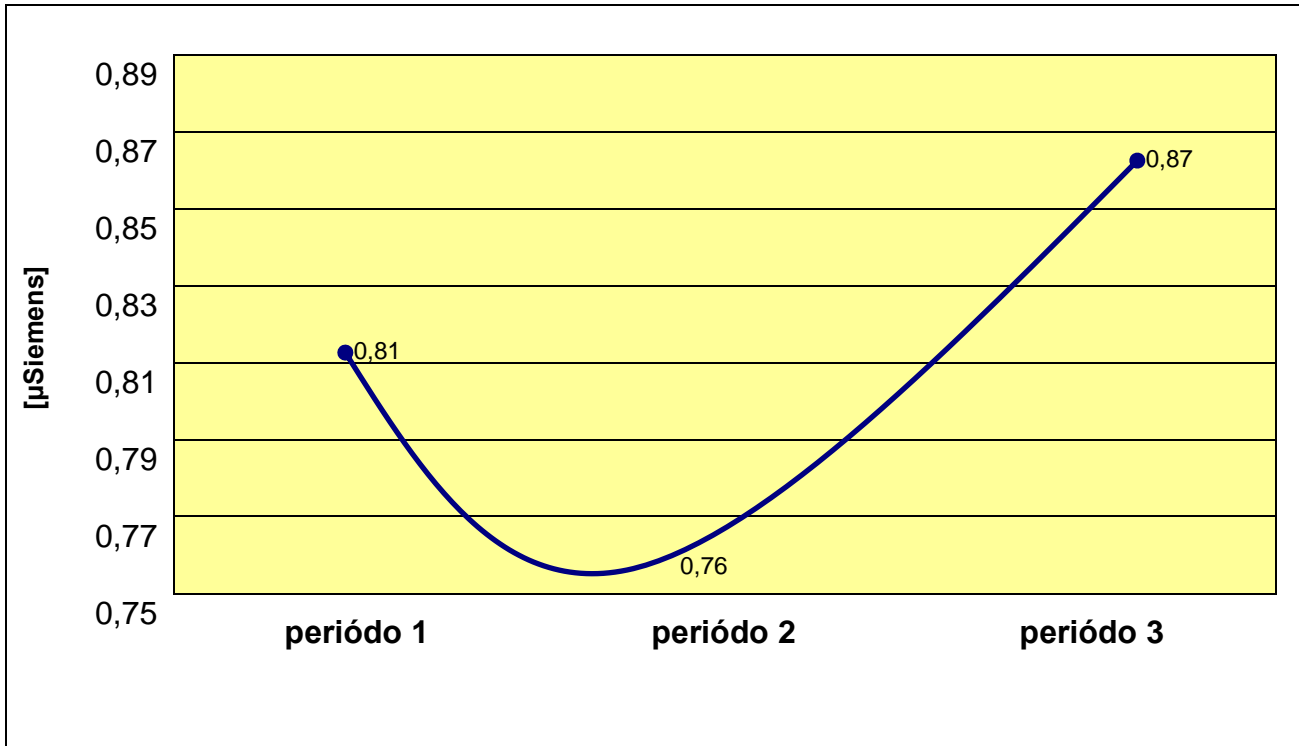

### 2. Mejoramiento de la variabilidad de las pulsaciones del corazón

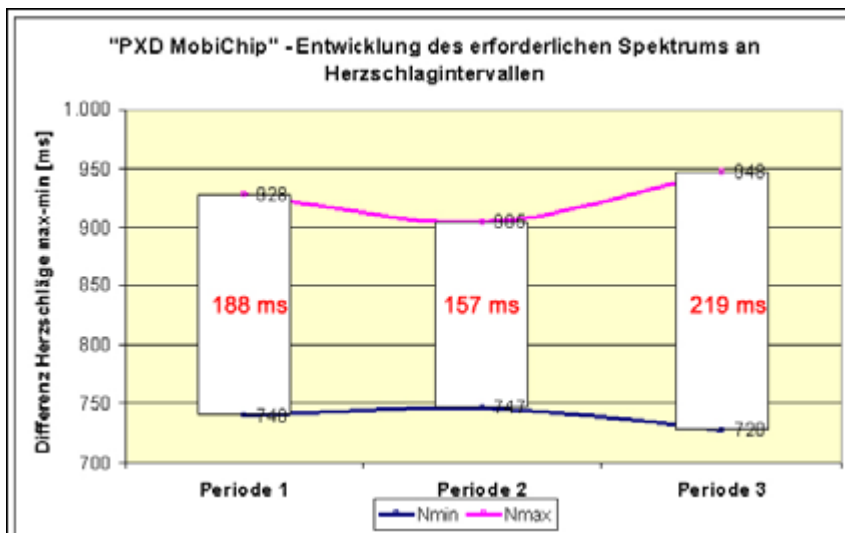

### “PXD Microchip” – Desarrollo de la potencia total (Total Power) del sistema nervioso vegetativo

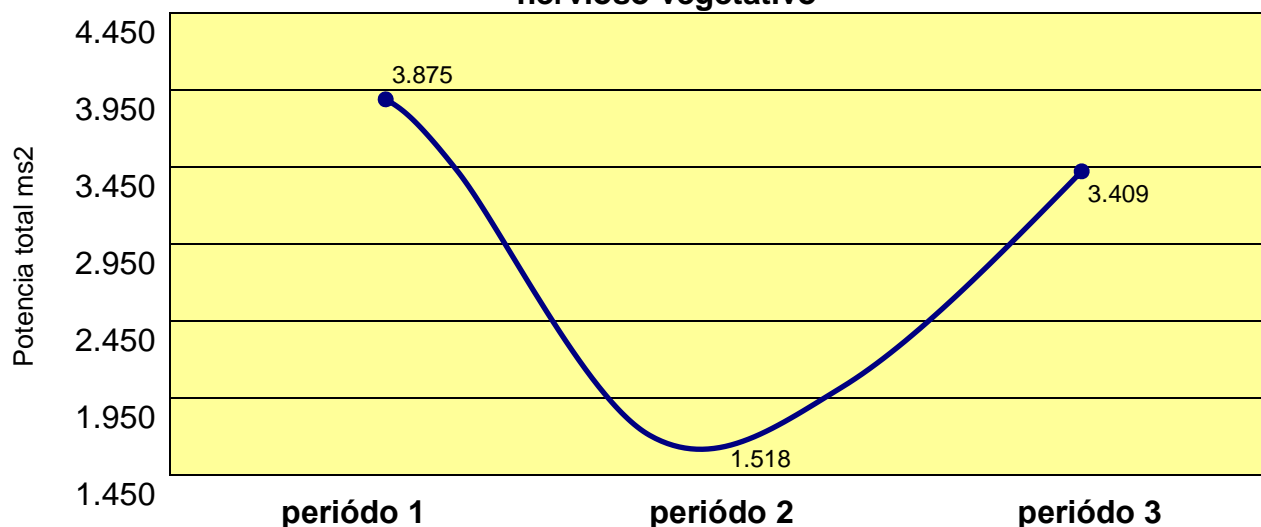

Los resultados de las investigaciones han mostrado que el campo informativo del “**PXD Microchip**” armoniza los efectos dañinos de los campos electromagnéticos durante su influencia biológica sobre el organismo y que contribuye al balance interno del organismo humano. La potencia total del sistema nervioso vegetativo se reduce mas de 50% cuando se usa el “**PXD Microchip**”. También se reduce el numero de registrados pares de intervalos consecutivos de las pulsaciones del corazón con una diferencia de > 50 ms, gracias al campo informativo del “**PXD Microchip**.”

Ingeniero Paul Summer  
Jefe del  
IGEF laboratorio para la investigación